

Destaques:

- Resultados quantitativos em apenas 5 minutos!
- Leitura com a tira molhada – secagem não é necessária
- Procedimento simples
- Sem necessidade de equipamentos de incubação
- Método Comum de extração com Kit QuickTox para Aflatoxina

Conteúdo do Kit:

- 50 tiras QuickTox embaladas em recipiente dessecante
- 100 tubos de reação
- 100 ponteiros de pipeta
- Tampão DB2

Itens Não Fornecidos:

- Agitador orbital/ rotatório
- Copos plásticos para amostra com tampa
- Solvente (etanol 50%)
- Peneira de 20 mesh
- Proveta graduada
- Pipeta de volume fixo: 100 µL
- Pipeta de volume fixo: 1 mL
- Timer
- Tesoura
- Sistema QuickScan



Amostra representativa com granulometria referente à peneira de 20 mesh (0,85mm)

Número de catálogo AQ 111 BG

Aplicação do Kit

O Kit QuickTox para QuickScan Fumonisina extrai e detecta rapidamente a presença de resíduos de Fumonisina em milho e sorgo. Este Kit foi desenvolvido para fornecer resultados quantitativos para resíduos de fumonisina em grãos de milho ou grãos de sorgo dentro do intervalo de 0,2 ppm a 6,0 ppm no teste padrão e até 20 ppm com uma etapa adicional de diluição. Para quantificação de fumonisina acima de 20 ppm, consultar o Serviço de Suporte Técnico.

Funcionamento do Teste

Primeiramente, é colhida uma amostra composta e em seguida, a fumonisina presente é extraída e solubilizada. Cada amostra deve ser triturada para uma espessura de 20 mesh e extraída com solvente diluído. Este extrato é posteriormente diluído para teste com o Kit QuickTox.

Cada tira QuickTox possui uma almofada de absorção em cada extremidade. A fita de proteção com a seta indica qual extremidade da tira deve ser inserida no tubo de reação. A amostra flui no sentido de baixo para cima, sendo absorvida na parte superior pela almofada de absorção. Completados 5 minutos, cortar e descartar a extremidade inferior da tira correspondente à fita com setas impressas. Inserir a tira no QuickScan para quantificação dos resultados.

Preparo das Amostras

Atenção: a amostra deve ser testada logo após a diluição com tampão (passo 9). Certifique-se de que as tiras e o tampão estejam em temperatura ambiente para serem utilizados antes do passo de diluição.

Determinar o tamanho da amostra

1. Preparar uma amostra composta de acordo com o seu próprio plano de amostragem ou de acordo com as instruções da USDA / GIPSA, encontradas nas referências de documentos como por exemplo na página: www.gipsa.usda.gov/publications/fgis/handbooks/gihbk1_inspbh.html, para obter ajuda para configurar um plano que se adapte às suas necessidades.
2. Triturar as amostras utilizando um moedor que produza uma amostra capaz de passar por uma peneira 20 mesh. Misturar bem o material moído antes da sub-amostragem.

Extração da amostra

3. Pesar 20-50 gramas de amostra triturada em um copo descartável com tampa e adicionar dois volumes de etanol 50% (2 mL por grama de amostra, ou seja, para 20 gramas, adicionar 40 mL). Para preparar ou comprar etanol 50% veja Precauções e Notas. NOTA: Manter o etanol tampado para evitar evaporação.
4. Tampar o copo e colocá-lo no agitador durante 1 minuto na velocidade máxima ou agitar as amostras manualmente (vigorosamente), durante 1½ a 2 minutos. Amostras não misturadas adequadamente podem ter uma extração incompleta e a performance do teste pode ser prejudicada.




Medir o solvente e adicionar à amostra triturada



Agitar mecanicamente ou manualmente



Adicionar o etanol 50% e em seguida o extrato da amostra ao primeiro tubo; misturar. Descartar a ponteira da pipeta.

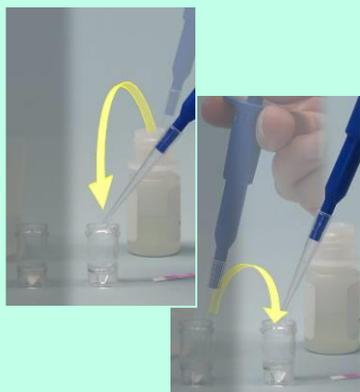

Com uma nova ponteira de pipeta, adicionar Tampão DB2 no segundo tubo. Em seguida, transferir a amostra diluída do tubo #1 para o tubo #2; misturar bem com a ponteira da pipeta.

- O extrato começará imediatamente a separar-se em camadas (uma amostra moída mais finamente pode levar alguns minutos para separar-se). Extrair a amostra do sobrenadante (camada superior) para realizar o teste.

Atenção: utilizar 2 tubos e 2 ponteiras de pipeta para cada amostra a ser testada: o primeiro 'conjunto' para a diluição e o segundo 'conjunto' para o teste.

Diluição (tubo #1):

- Utilizando uma pipeta de volume fixo e uma **nova ponteira**, colocar 100 microlitros (100 µL) de etanol 50% dentro do tubo de reação #1.
- Utilizando a mesma ponteira, remover 100 µL de amostra da camada superior (sobrenadante), evitando extrair partículas. Adicionar os 100 µL da amostra no tubo de reação #1, contendo o etanol. Misturar bem, utilizando a ponteira da pipeta e em seguida descartar a ponteira.

Teste (tubo #2):

- Com uma **nova ponteira** de pipeta, colocar 100 µL de Tampão DB2 no segundo tubo. Tomar cuidado para não contaminar o tampão – utilizar uma nova ponteira para cada teste – pipetar o tampão antes de pipetar a amostra diluída e manter o frasco do tampão fechado quando não estiver sendo usado.
- Utilizando a mesma ponteira, transferir 100 µL do extrato de amostra diluído (tubo #1) para o tubo #2, contendo o Tampão DB2. Misturar bem, utilizando a ponteira da pipeta até a mistura ficar uniforme (amarelo claro).

NOTAS: Amostras não misturadas adequadamente ou não pipetadas com precisão terão seu resultado prejudicado. Não reutilizar amostras diluídas. Utilizar dois novos tubos de reação para cada amostra. Utilizar duas ponteiras de pipeta (uma para o etanol e para o extrato do tubo #1 e uma para o Tampão DB2 e para o extrato diluído do tubo #2).


Para testar amostras acima de 6 ppm (até 20 ppm):

Se após a realização e leitura do teste o resultado inicial for maior que 6 ppm ("> 6 ppm" no QuickScan) e deseja-se saber o nível exato de contaminação, a amostra pode ser retestada através de um passo adicional de diluição do extrato da amostra.

- Em um novo tubo (tubo de diluição #1), misturar 100 µL de etanol 50% com 100 µL do extrato extraído da camada superior da amostra (medir cuidadosamente). Adicionar 1 mL de etanol 50% no mesmo tubo. **Misturar bem.**
- Utilizando uma pipeta de volume fixo e uma **nova ponteira**, colocar 100 microlitros (100 µL) de Tampão DB2 dentro de um segundo tubo (tubo de teste #2).
- Utilizando a **mesma** ponteira, transferir 100 µL do extrato de amostra diluído (tubo #1) para o tubo #2, contendo o Tampão DB2. Misturar bem. Devido a etapa adicional de diluição, o extrato pode não ter coloração amarelo claro.
- Seguir as instruções de **Como Realizar o Teste Tiras QuickTox**. Escolher 1:6 na tabela de diluição mostrada na tela de Resultados do QuickScan – o Sistema irá calcular e salvar o nível de fumonisina em amostras diluídas.



Colocar a tira no tubo de reação
Aguardar 5 minutos para os resultados

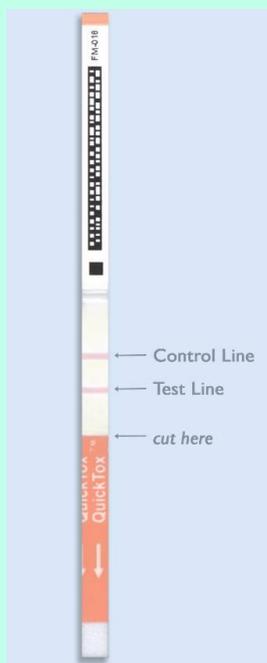

Cortar a tira e colocar no
QuickScan imediatamente —
sem etapa de secagem!



Colocar a tira no suporte do
QuickScan

Como Realizar o Teste Tiras QuickTox

1. Aguardar que o tubo com as tiras alcance a temperatura ambiente antes de destampá-lo. Remover as tiras do QuickTox que serão utilizadas. Evitar dobrar as tiras. Após o uso tampar o tubo imediatamente.
2. Colocar a tira dentro do tubo de reação contendo o tampão e o extrato de amostra diluído (tubo #2) . A fita adesiva com a seta na extremidade da tira deve apontar para dentro do tubo de reação.
3. A amostra deverá fluir na tira (o fluxo pode não ser visualizado imediatamente — isso é esperado e normal).
4. Aguardar 5 minutos de reação para iniciar a interpretação do resultado da tira. Imediatamente cortar e descartar a extremidade inferior da tira correspondente à fita com setas impressas. Colocar a tira no equipamento QuickScan para quantificação.

Uso do Sistema QuickScan

Instruções detalhadas sobre a utilização do Sistema QuickScan são fornecidas com cada unidade e também podem ser encontradas em www.envirologix.com/brasil.

Em resumo, a tira é inserida na fenda do suporte e o código de barras posicionado com a face virada para baixo e encaixado contra a parte traseira mais baixa da fenda e com as extremidades cortadas da tira apontando para o scanner. O suporte é empurrado para dentro do scanner e a leitura efetuada clicando-se em “Ler Teste” no Menu principal. Os resultados são então salvos em um arquivo eletrônico, permitindo a cada usuário controlar e reportar os resultados com facilidade.

Os resultados são reportados dentro do intervalo de 0,20 a 6,0 ppm. Resultados abaixo de 0,2 ppm aparecem como "<LOD" (menor que o Limite de Detecção) e resultados acima de 6,0 ppm aparecem como "> 6,0 ppm" .

Armazenamento do Kit

O Kit QuickTox deve ser armazenado sob refrigeração. Observar a validade descrita na caixa do kit. Sua exposição prolongada à temperaturas elevadas pode afetar adversamente os resultados dos testes. Abrir o tubo somente no momento do uso das tiras.

Reatividade Cruzada

As micotoxinas a seguir foram testadas com este kit utilizando os protocolos aqui especificados. Não ocorreram quaisquer resultados falsos positivos ao nível de 2000 ppm:

- Aflatoxina B1
- DON (deoxinivalenol)
- Ocratoxina A
- Zearalenona



Precauções e Notas

- Este produto não pode ser aplicado para nenhum outro tipo de cultura, além de milho e sorgo.
- Este ensaio é calibrado com amostras de referência fornecidas pelo Laboratório Trilogy Analytical, sediado em Washington, MO, e outros fornecedores e dados HPLC associados.
- Como todos os testes, é recomendado, quando necessário, que os resultados sejam confirmados por métodos alternativos.
- O teste foi desenvolvido para ser usado com o protocolo fornecido neste kit. Desvios deste protocolo podem invalidar os resultados deste teste. Pipetagem precisa, bem como mistura adequada e completa são essenciais para obterem-se resultados precisos.
- Os resultados gerados através do uso correto deste kit refletem a condição da amostra de trabalho diretamente testada. Extrapolações dessa condição aos respectivos lotes originais devem ser baseadas em procedimentos confiáveis de amostragem e cálculos estatísticos, os quais indicam os efeitos randômicos e não randômicos de amostragem de lotes de sementes e incerteza do ensaio. Um resultado negativo da amostra de trabalho obtido em testes corretamente realizados não significa, necessariamente, que o lote original é inteiramente negativo para a análise ou micotoxina em questão.
- As tiras devem ser lidas ainda molhadas, imediatamente após completarem-se os 5 minutos de reação.
- Proteger todos os componentes do kit de temperaturas extremas - quentes ou frias- quando não estiver em uso. Não expor à luz do sol ou à ambientes quentes no interior de veículos.
- Instruções para preparar Etanol 50%: Para 100 mL, medir 50 mL de etanol 100% [álcool etílico absoluto P.A. mínimo 99,5%] e colocar em um frasco apropriado com tampa. Adicionar 50 mL de água deionizada ou destilada. Fechar a tampa com segurança e agitar para misturar. Ter cuidado ao destampar.
- **IMPORTANTE:** O etanol é inflamável e tóxico. Evitar inalar vapores ou o contato com a pele, olhos ou roupa. Utilizar EPI apropriado incluindo óculos de segurança, luvas (não de látex), máscara e jaleco durante o manuseio. Manter o frasco bem fechado e longe de fontes de calor.
- Todo material de laboratório reutilizável (exemplo: jarra de vidro) deve ser bem lavado em água quente com sabão e enxaguado completamente antes de ser utilizado novamente.



EnviroLogix do Brasil Diagnósticos Ltda

Para Suporte Técnico Contatar:

suportetecnico@envirologix.com

Tel 1: + 55 (19) 3307-8887
Tel 2: + 55 (19) 4062-8887

Página na web:
www.envirologix.com.br

Contato Vendas:
vendas@envirologix.com

GARANTIA LIMITADA

EnviroLogix Inc. (“EnviroLogix”) garante os produtos vendidos nos termos deste instrumento (“os Produtos”) contra defeitos nos materiais e na fabricação quando usados de acordo com as instruções a ele aplicáveis por período não superior ao prazo de validade impresso na embalagem. Se o Produto não estiver em conformidade com a Garantia Limitada e o cliente notificar a EnviroLogix por escrito descrevendo os defeitos encontrados dentro do período de garantia, inclusive prontificando-se a devolvê-lo à EnviroLogix para avaliação, a EnviroLogix reparará ou substituirá, a seu critério exclusivo, qualquer produto ou parte do mesmo que comprovadamente apresente defeitos nos materiais ou de fabricação dentro do prazo de garantia.

A ENVIROLOGIX NÃO OFERECE NENHUM OUTRO TIPO DE GARANTIA, NEM EXPRESSA NEM TÁCITA, COMO, POR EXEMPLO, GARANTIA PARA FINS COMERCIAIS OU PARA FINALIDADES ESPECÍFICAS. A garantia ora prestada e os dados, especificações e descrições dos produtos da EnviroLogix encontrados em catálogos publicados e na literatura de produtos da EnviroLogix são as únicas declarações que a EnviroLogix reconhece referentes a seus Produtos e à garantia por ela oferecida. Nenhuma outra declaração ou afirmação, escrita ou verbal, por parte de funcionários, agentes ou representantes da EnviroLogix, salvo se firmada por escrito e assinada por encarregado devidamente autorizado da EnviroLogix Inc., será considerada autorizada nem deverá servir de embasamento para nenhum cliente, nem faz parte do contrato de venda ou da presente garantia.

A EnviroLogix não oferece garantia contra danos ou defeitos sofridos durante o transporte ou o manuseio de seus produtos, nem decorrentes de acidentes ou uso impróprio ou anormal dos Produtos, assim como não oferece garantia contra defeitos em produtos ou componentes que não sejam de sua fabricação. A EnviroLogix repassa ao cliente a garantia por ela recebida (se houver) do fabricante desses produtos ou de componentes fabricados por terceiros. A presente garantia também não se aplica a Produtos que tenham sofrido tentativa de alteração ou modificação que não tenham autorização por escrito fornecida pela EnviroLogix.

ESTA GARANTIA É EXCLUSIVA. A única e exclusiva obrigação da EnviroLogix será de reparar ou trocar os Produtos defeituosos de maneira e no período anteriormente mencionado. Com respeito aos Produtos ou qualquer parte dos mesmos a EnviroLogix não assume e não assumirá nenhuma outra obrigação, agravante, responsabilidade estrita ou qualquer outra base que não esteja nesta Garantia. Em nenhuma circunstância baseada nesta Garantia Limitada, a EnviroLogix se responsabilizará por danos acidentais, especiais ou consequentes.

Esta Garantia Limitada expressa a totalidade das obrigações da EnviroLogix com respeito aos Produtos. Se se determinar que qualquer parte desta Garantia Limitada é inaplicável ou ilegal, o restante da mesma permanecerá em plena vigência.

Licença

Este kit foi desenvolvido com o uso de reagentes próprios da EnviroLogix.

EnviroLogix, o logotipo da EnviroLogix, QuickTox e QuickScan, são marcas registradas da EnviroLogix Inc.

© EnviroLogix 2013